

『医薬品の封の取扱い等について』に関する情報のご案内

拝啓 時下益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配をうけ賜り、厚く御礼申し上げます。

平成30年8月1日付で厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医薬品の封の取扱い等について」（薬生発0801第1号）を受け、弊社の医療用医薬品の封に関する情報をご案内申し上げます。

謹白

弊社製品 個装ケースの封緘種類

- 粘着テープ 封緘型【押し開け式】
- 粘着テープ 封緘型【引き開け式】
- 粘着テープ 封緘型【ミシン目なし】
- 接着剤 封緘型【押し開け式】
- 接着剤 封緘型【引き開け式】
- 接着剤 封緘型【ジッパー式】

粘着テープ封緘型

未開封の状態

【押し開け式】 【引き開け式】

- ・ ミシン目が切れていないこと

【押し開け式】 【引き開け式】 【ミシン目なし】

- ・ 粘着テープがしっかり貼付されていること

【押し開け式】 【引き開け式】 【ミシン目なし】

- ・ 箱全体に不自然な破れ等がないこと

開封方法

【押し開け式】

- ・ 開封口のミシン目に沿って押し開ける

【引き開け式】


- ・ 開封口のミシン目に沿って引き開ける

【ミシン目なし】

- ・ 粘着テープを剥がして開封する


開封後の状態

【押し開け式】

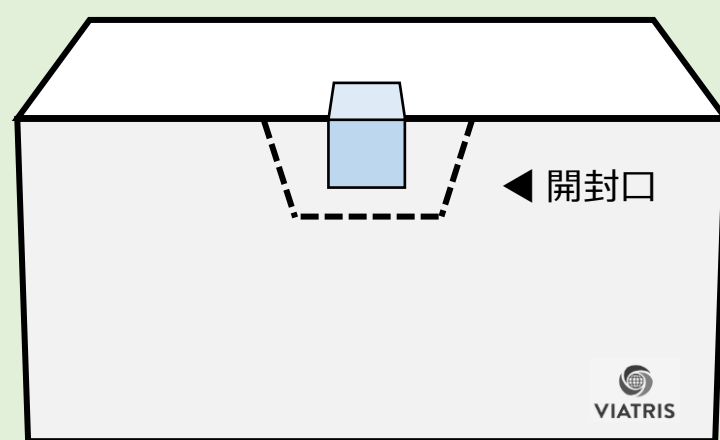

押し開ける

開封口

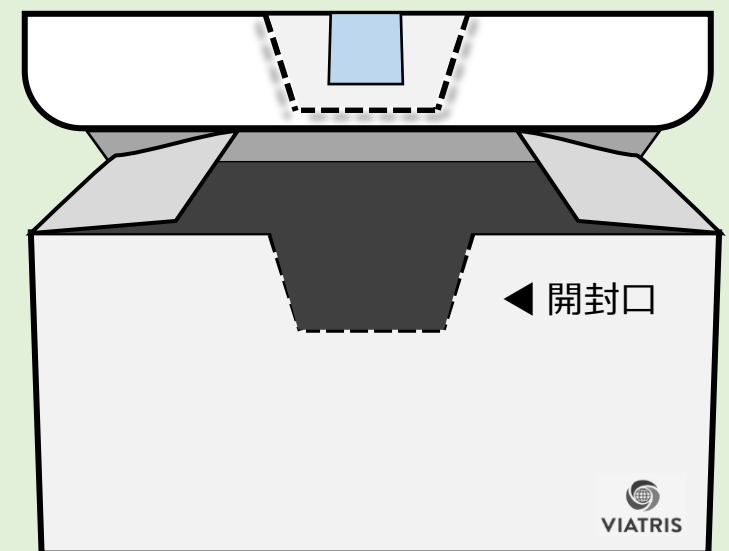

【引き開け式】




引き開ける



開封口






【ミシン目なし】

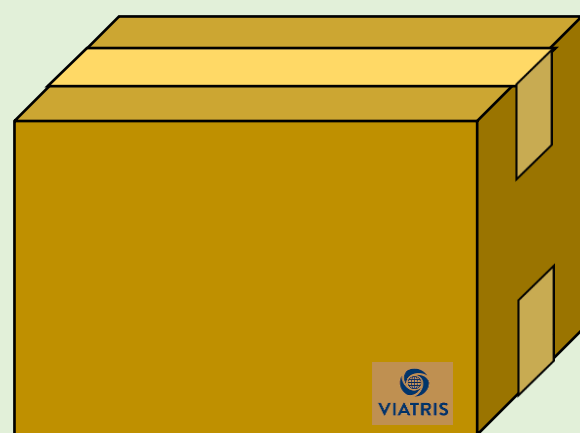

テープを剥がす

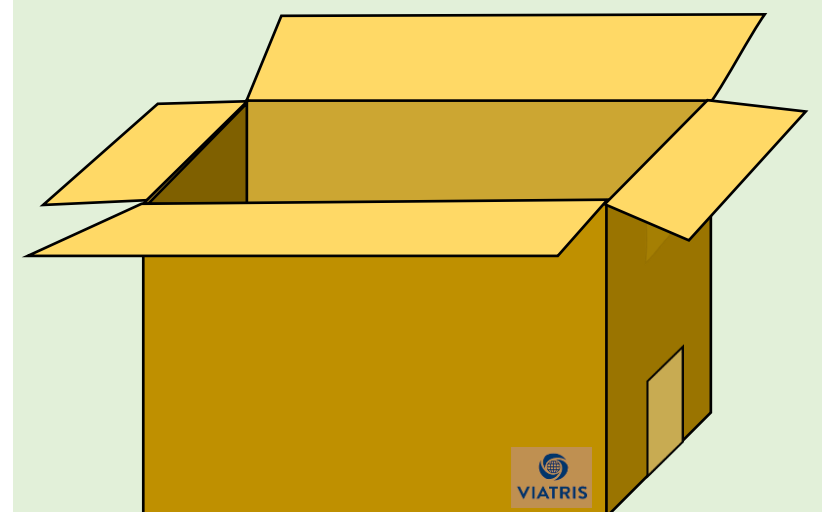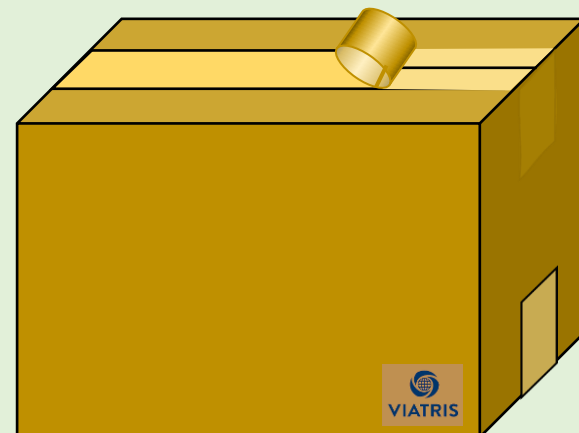

⚠ 以下の場合には開封されている可能性があります。

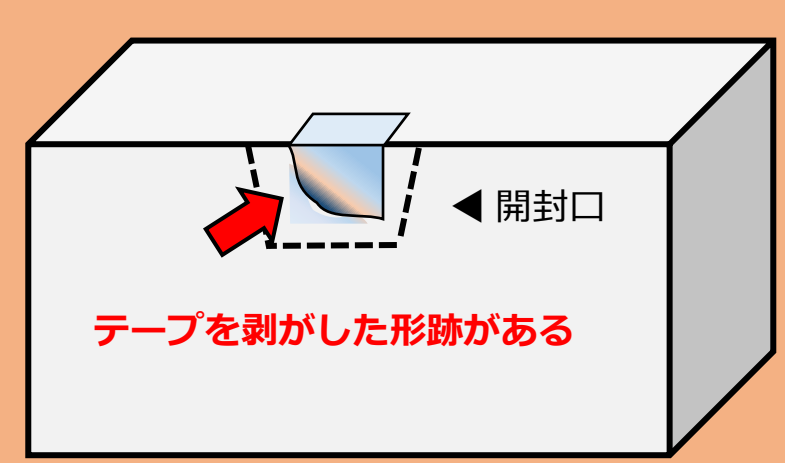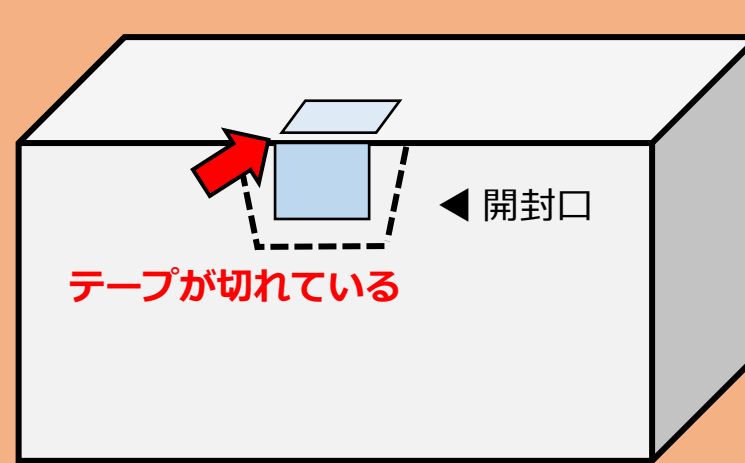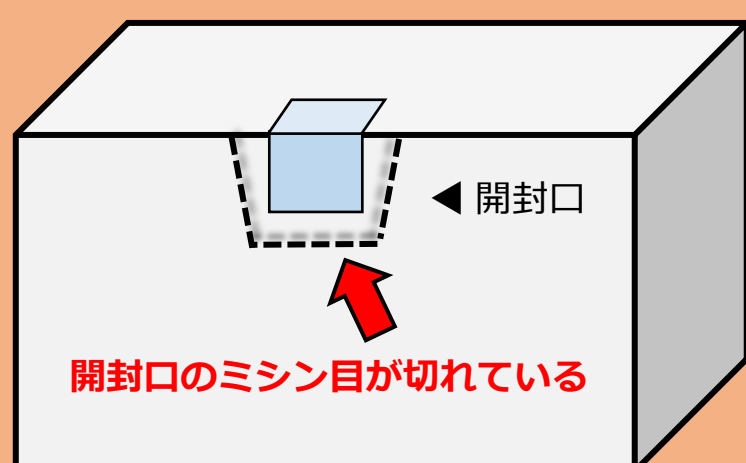

接着剤封緘型

未開封の状態

【押し開け式】 【引き開け式】 【ジッパー式】

- ・ミシン目が切れていないこと
- ・しっかりと糊付け封緘されていること
- ・箱全体に不自然な破れ等がないこと

開封方法

【押し開け式】


- ・開封口のミシン目に沿って押し開ける

【引き開け式】 【ジッパー式】


- ・開封口のミシン目に沿って引き開ける

開封後の状態

【押し開け式】

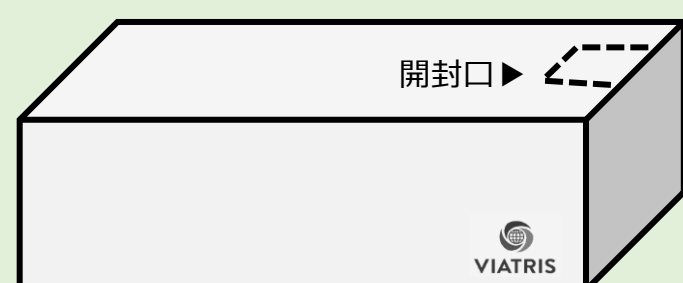

押し開ける

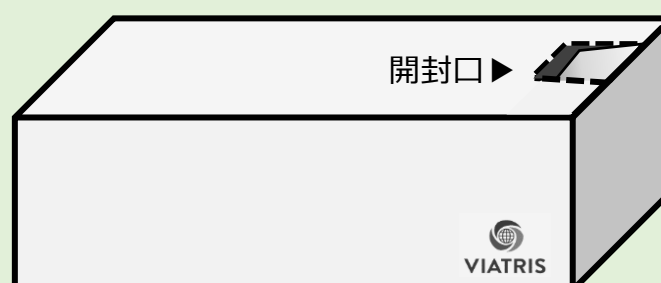


【引き開け式】




引き開ける




【ジッパー式】

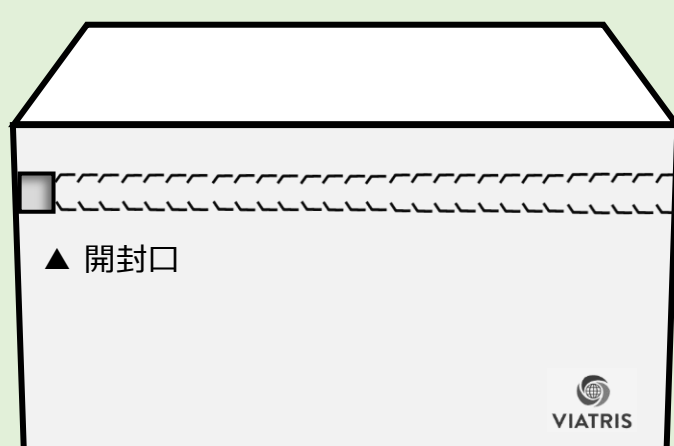

引き開ける

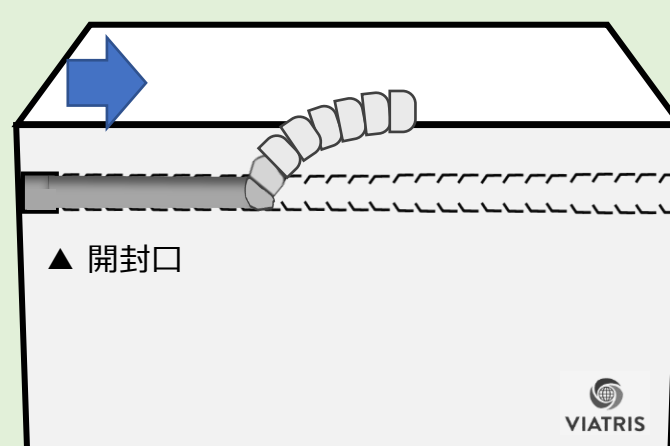

※一部の製品で粘着テープ仕様もございます。

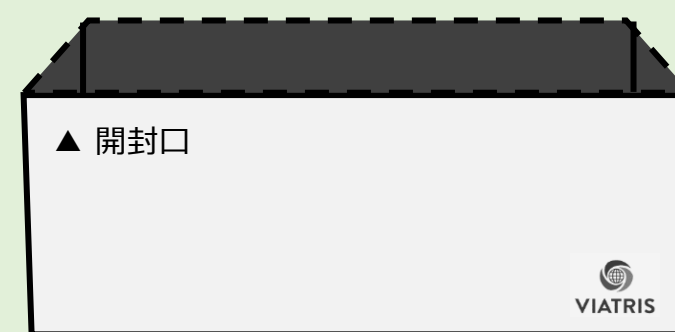

以下の場合には開封されている可能性があります。

